Burettes
Burettes

Burettes class B, short line graduation acc. to DIN EN ISO 385.
Amber stain graduations and inscriptions „DIFFICO“, resistant to alkalis and acids and abrasion with beaded rims which have considerable mechanical strength. All plugs with screw thread retaining nuts. Calibrated to deliver, made of DURAN.
Delivery time 35 - 60 s, without waiting time

Burettes graduées classe B selon DIN 12700 (ISO/R385)
en verre borosilicaté, graduations et inscriptions en couleur brun à haute résistance chimique, bord évasé et robinet avec vis de fixation.
Temps d'écoulement 35-60 sec., sans attente.
En verre borosilicaté

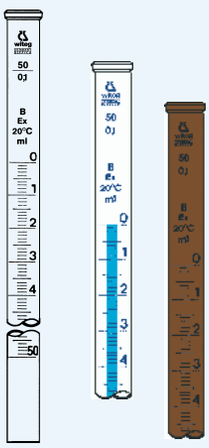

3.000.* - 3.004*****

Burette tubes class B, short line graduation, to fuse on, made of clear borosilicate glass

Burettes droites graduées classe B, *tube seul en verre clair borosilicaté, sans robinet*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.000.050**
10	0.02	± 0.03	**3.000.100**
25	0.05	± 0.04	**3.000.250**
50	0.10	± 0.08	**3.000.500**
100	0.20	± 0.15	**3.000.900**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.002.050**
10	0.02	± 0.03	**3.002.100**
25	0.05	± 0.04	**3.002.250**
50	0.10	± 0.08	**3.002.500**
100	0.20	± 0.15	**3.002.900**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.004.050**
10	0.02	± 0.03	**3.004.100**
25	0.05	± 0.04	**3.004.250**
50	0.10	± 0.08	**3.004.500**
100	0.20	± 0.15	**3.004.900**

3.002.1**

Burettes class B, with tip, rubber and tubing, **Schellbach blue line**, made of borosilicate glass

Burettes droites graduées classe B, *en verre avec bande en émail blue, sans robinet, avec embout, caoutchouc et tube*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.002.051**
10	0.02	± 0.03	**3.002.101**
25	0.05	± 0.04	**3.002.251**
50	0.10	± 0.08	**3.002.501**
100	0.20	± 0.15	**3.002.901**

Burettes class B, short line graduation, with straight stopcock, with solid ST-glass-plug, made of clear borosilicate glass

Burettes droites graduées classeB, *en verre clair borosilicaté et robinet à clé en verre interchangeable*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.000.052**
10	0.02	± 0.03	**3.000.102**
25	0.05	± 0.04	**3.000.252**
50	0.10	± 0.08	**3.000.502**
100	0.20	± 0.15	**3.000.902**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.002.052**
10	0.02	± 0.03	**3.002.102**
25	0.05	± 0.04	**3.002.252**
50	0.10	± 0.08	**3.002.502**
100	0.20	± 0.15	**3.002.902**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.004.052**
10	0.02	± 0.03	**3.004.102**
25	0.05	± 0.04	**3.004.252**
50	0.10	± 0.08	**3.004.502**
100	0.20	± 0.15	**3.004.902**

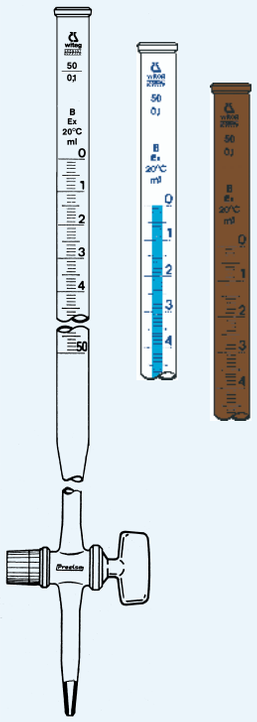

3.002.2**
-
3.004.2**

Burettes class B, short line graduation, with straight stopcock, with PTFE-plug, made of clear borosilicate glass

Burettes droites graduées classe B, *en verre clair borosilicaté et robinet à clé en Téflon (PTFE) interchangeable*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.000.053**
10	0.02	± 0.03	**3.000.103**
25	0.05	± 0.04	**3.000.253**
50	0.10	± 0.08	**3.000.503**
100	0.20	± 0.15	**3.000.903**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.002.053**
10	0.02	± 0.03	**3.002.103**
25	0.05	± 0.04	**3.002.253**
50	0.10	± 0.08	**3.002.503**
100	0.20	± 0.15	**3.002.903**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.004.053**
10	0.02	± 0.03	**3.004.103**
25	0.05	± 0.04	**3.004.253**
50	0.10	± 0.08	**3.004.503**
100	0.20	± 0.15	**3.004.903**

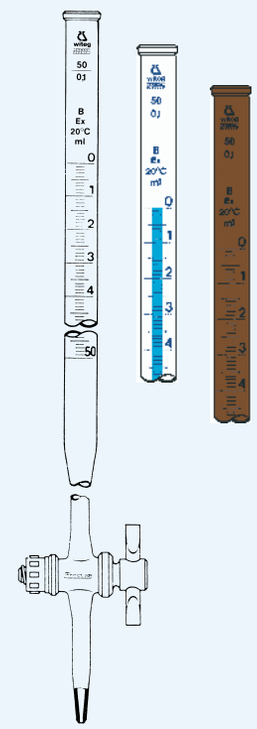

3.000.3**
-
3.004.3**

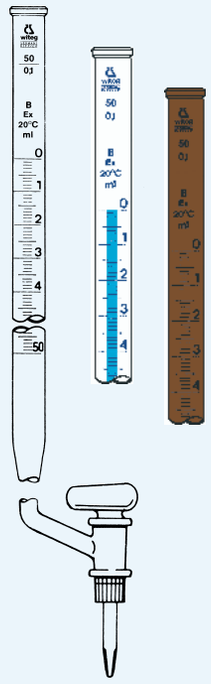

3.002.*4**
-
3.004.*4**

Burettes class B, short line graduation, with lateral stopcock, with solid ST-glass-plug, made of clear borosilicate glass

Burettes graduées classe B,
en verre clair borosilicaté avec robinet latéral à clé en verre interchangeable

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.000.054**
10	0.02	± 0.03	**3.000.104**
25	0.05	± 0.04	**3.000.254**
50	0.10	± 0.08	**3.000.504**
100	0.20	± 0.15	**3.000.904**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.002.054**
10	0.02	± 0.03	**3.002.104**
25	0.05	± 0.04	**3.002.254**
50	0.10	± 0.08	**3.002.504**
100	0.20	± 0.15	**3.002.904**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.004.054**
10	0.02	± 0.03	**3.004.104**
25	0.05	± 0.04	**3.004.254**
50	0.10	± 0.08	**3.004.504**
100	0.20	± 0.15	**3.004.904**

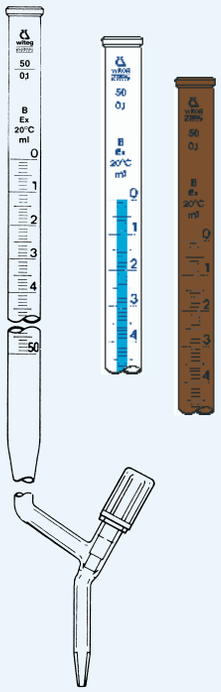

3.002.*5**
-
3.004.*5**

Burettes class B, short line graduation, with lateral needle valve stopcock, with PTFE-needle valve, with overtwist device, made of clear borosilicate glass

Burettes graduées classe B,
en verre clair borosilicaté à robinet latéral avec vanne à aiguille en téflon interchangeable

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.000.055**
10	0.02	± 0.03	**3.000.105**
25	0.05	± 0.04	**3.000.255**
50	0.10	± 0.08	**3.000.505**
100	0.20	± 0.15	**3.000.905**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.002.055**
10	0.02	± 0.03	**3.002.105**
25	0.05	± 0.04	**3.002.255**
50	0.10	± 0.08	**3.002.505**
100	0.20	± 0.15	**3.002.905**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.004.055**
10	0.02	± 0.03	**3.004.105**
25	0.05	± 0.04	**3.004.255**
50	0.10	± 0.08	**3.004.505**
100	0.20	± 0.15	**3.004.905**

Burettes class B, short line graduation, with two-way stopcock, with ST-glass-plug, made of clear borosilicate glass

Burettes droites graduées classe B, *en verre clair borosilicaté avec robinet à 2 voies à clé en verre interchangeable*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.000.056**
10	0.02	± 0.03	**3.000.106**
25	0.05	± 0.04	**3.000.256**
50	0.10	± 0.08	**3.000.506**
100	0.20	± 0.15	**3.000.906**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.002.056**
10	0.02	± 0.03	**3.002.106**
25	0.05	± 0.04	**3.002.256**
50	0.10	± 0.08	**3.002.506**
100	0.20	± 0.15	**3.002.906**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.004.056**
10	0.02	± 0.03	**3.004.106**
25	0.05	± 0.04	**3.004.256**
50	0.10	± 0.08	**3.004.506**
100	0.20	± 0.15	**3.004.906**

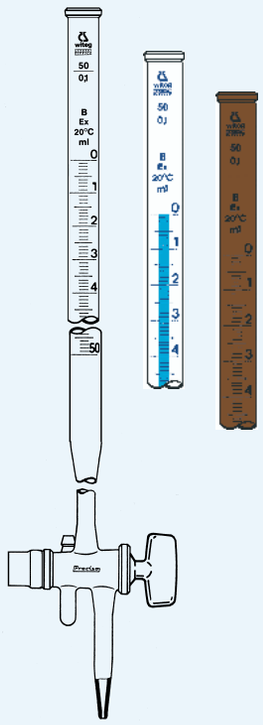

3.002.**6**
-
3.004.**6**

Burettes class DIN-B, short line graduation, with straight valve stopcock, with overtwist safety, made of clear borosilicate glass

Burettes droites graduées classe DIN-B, *en verre clair borosilicaté avec robinet à vanne à aiguille interchangeable*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.000.057**
10	0.02	± 0.03	**3.000.107**
25	0.05	± 0.04	**3.000.257**
50	0.10	± 0.08	**3.000.507**
100	0.20	± 0.15	**3.000.907**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.002.057**
10	0.02	± 0.03	**3.002.107**
25	0.05	± 0.04	**3.002.257**
50	0.10	± 0.08	**3.002.507**
100	0.20	± 0.15	**3.002.907**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.02	**3.004.057**
10	0.02	± 0.03	**3.004.107**
25	0.05	± 0.04	**3.004.257**
50	0.10	± 0.08	**3.004.507**
100	0.20	± 0.15	**3.004.907**

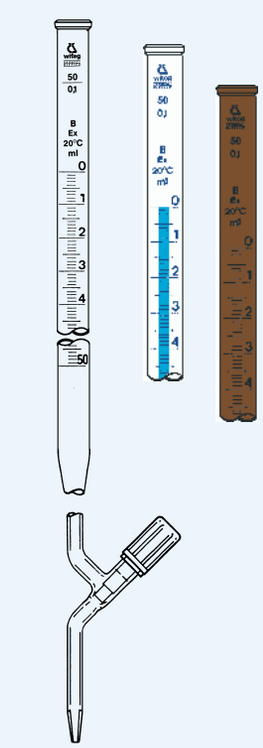

3.002.**7**
-
3.004.**7**

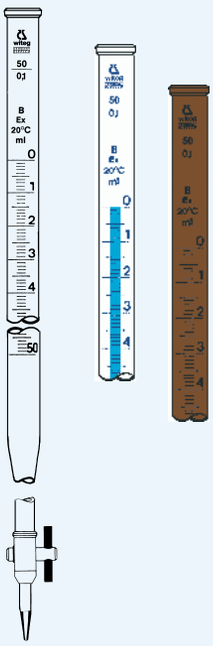

3.000.*8**
-
3.004.*8**

Burettes class B, short line graduation, with new detachable PTFE-stopcock (House and plug complete made of PTFE), bore 2.5 mm, with O-ring gasket and intercangeable glass tip, made of clear borosilicate glass

Burettes droites graduées classe B, *en verre clair borosilicaté avec robinet à clé en Téflon (PTFE) et pointe en verre interchangeable avec joint*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
25	0.05	± 0.04	**3.000.258**
50	0.10	± 0.08	**3.000.508**
100	0.20	± 0.15	**3.000.908**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
25	0.05	± 0.04	**3.002.258**
50	0.10	± 0.08	**3.002.508**
100	0.20	± 0.15	**3.002.908**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
25	0.05	± 0.04	**3.004.258**
50	0.10	± 0.08	**3.004.508**
100	0.20	± 0.15	**3.004.908**

Spare parts

Pièces de rechange

	Order No. *N° de code*
PTFE-stopcock, without glass-tip *Robinet en téflon, sans pointe en verre*	**3.004.910**
Glass-tip *Pointe en verre*	**3.004.911**



3.012.*1**

Burettes class AS, conformity certified, main point ring-graduation, acc. to DIN EN ISO 385).
Amber stain graduations and inscriptions „DIFFICO“, resistant to alkalis and acids and abrasion with beaded rims which have considerable mechanical strength. All plugs with screw thread retaining nuts. Calibrated to deliver.
Delivery time 35 - 45 s, waiting time 30 s.
Made of DURAN

Burettes graduées classe AS, *avec certificat de conformité, selon DIN EN ISO 385.*
Graduations en couleur brun à haute résistance chimique, bordure évasée. Toutes les clés de robinets avec vis de fixation.
Temps d'écoulement 35-45 sec., attente 30 sec.
En verre DURAN

Burettes class AS, conformity certified, with tip, rubber and tubing, **Schellbach blue line**, made of borosilicate glass

Burettes droites graduées classe AS, *certifiées conformes, en verre borosilicaté à bande en émail bleu avec pointe en verre, caoutchouc et tube*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.01	**3.012.051**
10	0.02	± 0.02	**3.012.101**
25	0.05	± 0.03	**3.012.251**
50	0.10	± 0.05	**3.012.501**
100	0.20	± 0.10	**3.012.901**

Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments, please refer to pages 171/1 and 171/2
Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG, veuillez svp vous référer aux pages 171/3 et 171/4

Burettes class AS, conformity certified, main point ring graduation, with straight stopcock, with solid ST-glass-plug, made of clear borosilicate glass

Burettes droites graduées classe AS, *certifiées conformes, en verre clair borosilicaté avec robinet à clé en verre interchangeable*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.010.102**
25	0.05	± 0.03	**3.010.252**
50	0.10	± 0.05	**3.010.502**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.01	**3.012.052**
10	0.02	± 0.02	**3.012.102**
25	0.05	± 0.03	**3.012.252**
50	0.10	± 0.05	**3.012.502**
100	0.20	± 0.10	**3.012.902**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.014.102**
25	0.05	± 0.03	**3.014.252**
50	0.10	± 0.05	**3.014.502**

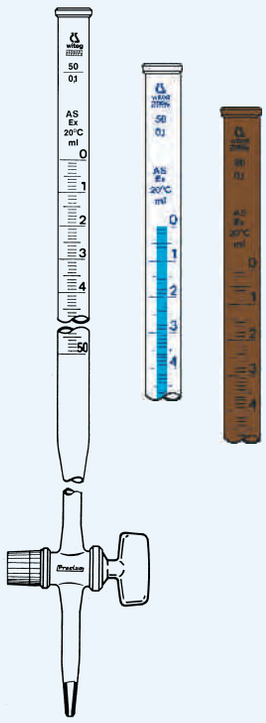

3.010.****2**
-
3.014.****2**

Burettes class AS, conformity certified, main point ring graduation, with straight stopcock, with ST-PTFE-plug, made of clear borosilicate glass

Burettes droites graduées classe AS *certifiées conformes, en verre clair borosilicaté avec robinet à clé en téflon interchangeable*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.010.103**
25	0.05	± 0.03	**3.010.253**
50	0.10	± 0.05	**3.010.503**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.01	**3.012.053**
10	0.02	± 0.02	**3.012.103**
25	0.05	± 0.03	**3.012.253**
50	0.10	± 0.05	**3.012.503**
100	0.20	± 0.10	**3.012.903**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.014.103**
25	0.05	± 0.03	**3.014.253**
50	0.10	± 0.05	**3.014.503**

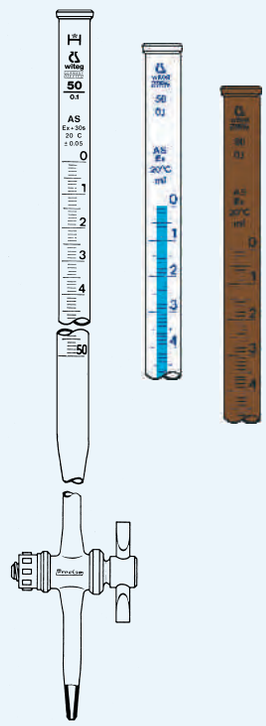

3.010.****3**
-
3.014.****3**

Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments, please refer to pages 171/1 and 171/2

Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG, veuillez svp vous référer aux pages 171/3 et 171/4

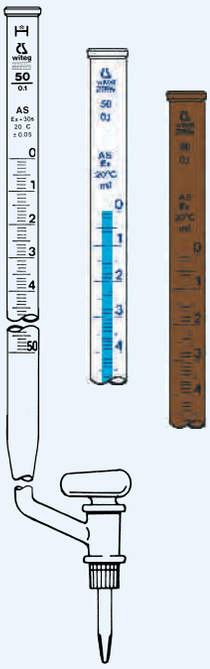

3.010.*4**
-
3.014.*4**

Burettes class AS, conformity certified, main point ring graduation, with lateral stopcock, with solid ST-glass-plug, made of clear borosilicate glass

Burettes graduées classe AS *certifiées conformes, en verre clair borosilicaté avec robinet latéral à clé en verre interchangeable*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.010.104**
25	0.05	± 0.03	**3.010.254**
50	0.10	± 0.05	**3.010.504**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.01	**3.012.054**
10	0.02	± 0.02	**3.012.104**
25	0.05	± 0.03	**3.012.254**
50	0.10	± 0.05	**3.012.504**
100	0.20	± 0.10	**3.012.904**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.014.104**
25	0.05	± 0.03	**3.014.254**
50	0.10	± 0.05	**3.014.504**

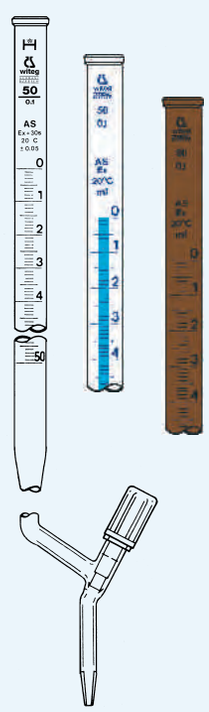

3.010.*5**
-
3.014.*5**

Burettes class AS, conformity certified, main point ring graduation, with lateral needle valve stopcock, with PTFE-needle valve, with overtwist device, made of clear borosilicate glass

Burettes graduées classe AS *certifiées conformes, en verre clair borosilicaté avec robinet latéral à vanne à aiguille en Téflon (PTFE) interchangeable*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.010.105**
25	0.05	± 0.03	**3.010.255**
50	0.10	± 0.05	**3.010.505**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.01	**3.012.055**
10	0.02	± 0.02	**3.012.105**
25	0.05	± 0.03	**3.012.255**
50	0.10	± 0.05	**3.012.505**
100	0.20	± 0.10	**3.012.905**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.014.105**
25	0.05	± 0.03	**3.014.255**
50	0.10	± 0.05	**3.014.505**

Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments, please refer to pages 171/1 and 171/2

Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG, veuillez svp vous référer aux pages 171/3 et 171/4

Burettes class AS, conformity certified, main point ring graduation, with straight needle valve stopcock, with PTFE-needle valve, with overtwist device, made of clear borosilicate glass

Burettes droites graduées classe AS *certifiées conformes, en verre clair borosilicaté à robinet avec vanne à aiguille en Téflon (PTFE) interchangeable*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.020.107**
25	0.05	± 0.03	**3.020.257**
50	0.10	± 0.05	**3.020.507**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
5	0.02	± 0.01	**3.022.057**
10	0.02	± 0.02	**3.022.107**
25	0.05	± 0.03	**3.022.257**
50	0.10	± 0.05	**3.022.507**
100	0.20	± 0.10	**3.022.907**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.024.107**
25	0.05	± 0.03	**3.024.257**
50	0.10	± 0.05	**3.024.507**

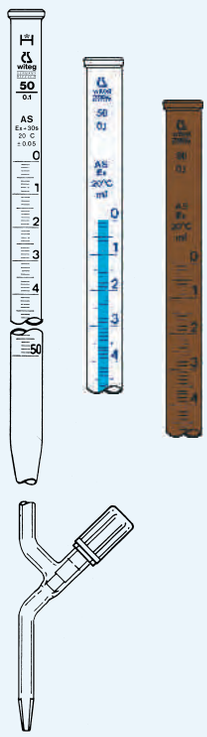

3.020.7**
-
3.024.7**

Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments, please refer to pages 171/1 and 171/2

Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG, veuillez svp vous référer aux pages 171/3 et 171/4

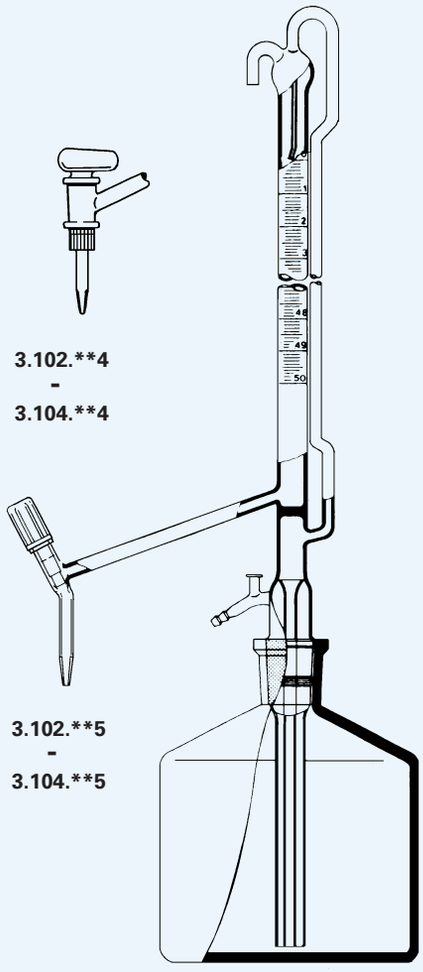

3.102.**4
-
3.104.**4

3.102.**5
-
3.104.**5

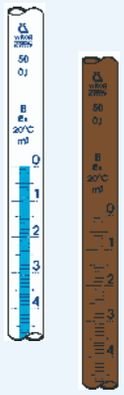

Automatic burettes, Pellet class B
short line graduation, without stopcock between burette and reservoir, with lateral stopcock, with solid ST-glass-plug, with 2 l reservoir bottle, without aspirator bulb, DURANborosilicate glass

Burettes automatiques de Pellet, classe B, *sans robinet entre la burette et le flacon, avec robinet latéral à clé en verre plein interchangeable et flacon de 2 litres en verre clair borosilicaté, mais sans poire en caoutchouc*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.03	**3.102.104**
25	0.05	± 0.05	**3.102.254**
50	0.10	± 0.08	**3.102.504**
100	0.20	± 0.20	**3.102.904**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.03	**3.104.104**
25	0.05	± 0.05	**3.104.254**
50	0.10	± 0.08	**3.104.504**
100	0.20	± 0.20	**3.104.904**

Automatic burettes, Pellet class B, short line graduation, without stopcock between burette and reservoir, with lateral neeldle valve stopcock, with PTFE-needle valve, with overtwist device, with 2 l reservoir bottle, without aspirator bulb, made of DURAN

Burettes automatiques de Pellet, classe B, *sans robinet entre la burette et le flacon, avec robinet latéral à vanne à aiguille en téflon interchangeable et flacon de 2 litres en verre clair borosilicaté, mais sans poire en caoutchouc*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.03	**3.102.105**
25	0.05	± 0.05	**3.102.255**
50	0.10	± 0.08	**3.102.505**
100	0.20	± 0.20	**3.102.905**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.03	**3.104.105**
25	0.05	± 0.05	**3.104.255**
50	0.10	± 0.08	**3.104.505**
100	0.20	± 0.20	**3.104.905**

For the TITREX digital burettes, please refer to page 246
Pour les burettes digitales TITREX, se référer svp à la page 246

Automatic burettes, Pellet class B, short line graduation, with stopcock, with hollow ST-glass-plug, between burette and reservoir, with lateral stopcock, with solid ST-glass-plug, with 2 l reservoir bottle, without aspirator bulb, made of DURAN

Burettes automatiques de Pellet, classe B, *avec robinet à clé interchangeable en verre creux entre la burette et le flacon, robinet latéral à clé en verre plein interchangeable et flacon de 2 litres en verre clair borosilicaté, mais sans poire en caoutchouc*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.03	**3.112.106**
25	0.05	± 0.05	**3.112.256**
50	0.10	± 0.08	**3.112.506**
100	0.20	± 0.20	**3.112.906**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.03	**3.114.106**
25	0.05	± 0.05	**3.114.256**
50	0.10	± 0.08	**3.114.506**
100	0.20	± 0.20	**3.114.906**

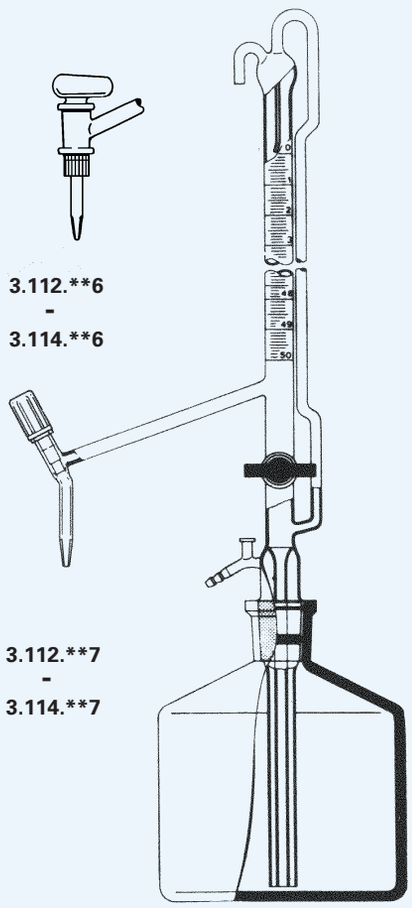

3.112.****6**
-
3.114.****6**

Automatic burettes, Pellet class B, short line graduation, with stopcock, with hollow ST-glass-plug, between burette and reservoir, with lateral needle valve, with PTFE-needle valve, with overtwist device, with 2 l reservoir bottle, without aspirator bulb, made of DURAN

Burettes automatiques de Pellet, classe B, *avec robinet à clé interchangeable en verre creux entre la burette et le flacon, robinet latéral à vanne à aiguille en téflon interchangeable et flacon de 2 litres en verre clair borosilicaté, mais sans poire en caoutchouc*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.03	**3.112.107**
25	0.05	± 0.05	**3.112.257**
50	0.10	± 0.08	**3.112.507**
100	0.20	± 0.20	**3.112.907**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.03	**3.114.107**
25	0.05	± 0.05	**3.114.257**
50	0.10	± 0.08	**3.114.507**
100	0.20	± 0.20	**3.114.907**

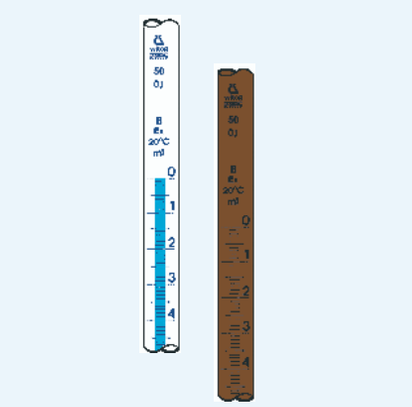

3.112.****7**
-
3.114.****7**

For the TITREX digital burettes, please refer to page 246
Pour les burettes digitales TITREX, se référer svp à la page 246

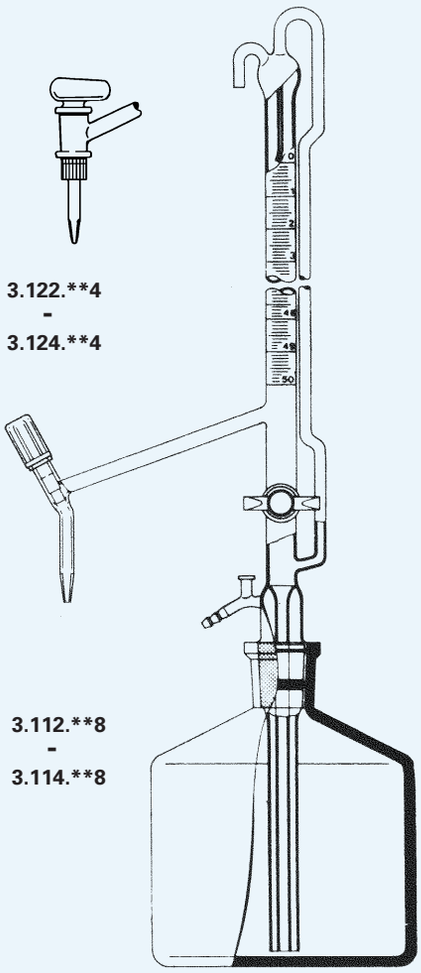

3.122.*4**
-
3.124.*4**

3.112.*8**
-
3.114.*8**

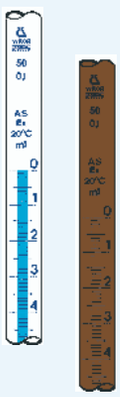

Automatic burettes, Pellet, class B, short line graduation, with stopcock, with ST-PTFE-plug, between burette and reservoir, with lateral needle valve, with PTFE-needle valve, with overtwist device, with 2 l reservoir bottle, without aspirator bulb, made of DURAN

Burettes automatiques de Pellet, classe B, *avec robinet à clé en téflon entre la burette et le flacon, robinet latéral à vanne à aiguille en téflon (PTFE) interchangeable et flacon de 2 litres en verre clair borosilicaté, mais sans poire en caoutchouc*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.03	**3.112.108**
25	0.05	± 0.05	**3.112.258**
50	0.10	± 0.08	**3.112.508**
100	0.20	± 0.20	**3.112.908**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.03	**3.114.108**
25	0.05	± 0.05	**3.114.258**
50	0.10	± 0.08	**3.114.508**
100	0.20	± 0.20	**3.114.908**

Automatic burettes, Pellet, class AS, conformity certified, main point ring-graduation, without stopcock between burette and reservoir, with lateral stopcock, with solid ST-glass-plug, with 2 l reservoir bottle without aspirator bulb, made of DURAN

Burettes automatiques de Pellet, classe AS *certifiée conforme, sans robinet entre la burette et le flacon, avec robinet latéral à clé en verre interchangeable et flacon de 2 litres en verre clair borosilicaté, mais sans poire en caoutchouc*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.122.104**
25	0.05	± 0.03	**3.122.254**
50	0.10	± 0.05	**3.122.504**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.124.104**
25	0.05	± 0.03	**3.124.254**
50	0.10	± 0.05	**3.124.504**

For the TITREX digital burettes, please refer to page 246
Pour les burettes digitales TITREX, se référer svp à la page 246

Automatic burettes, Pellet, class AS, conformity certified, main point ring-graduation, without stopcock between burette and reservoir, with lateral needle valve stopcock, with PTFE-needle valve, with overtwist device, with 2 l reservoir bottle without aspirator bulb, made of DURAN

Burettes automatiques de Pellet, classe AS *certifiée conforme, sans robinet entre la burette et le flacon, avec robinet latéral à vanne à aiguille en téflon interchangeable et flacon de 2 litres en verre clair borosilicaté, mais sans poire en caoutchouc*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.122.105**
25	0.05	± 0.03	**3.122.255**
50	0.10	± 0.05	**3.122.505**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.124.105**
25	0.05	± 0.03	**3.124.255**
50	0.10	± 0.05	**3.124.505**

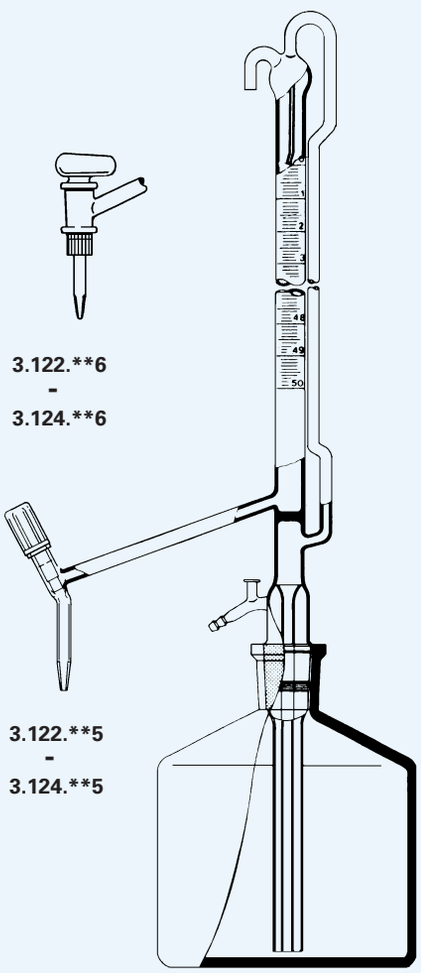

3.122.**6**
-
3.124.**6**

3.122.**5**
-
3.124.**5**

Automatic burettes, Pellet, class AS, conformity certified, main point ring-graduation, with stopcock, with hollow ST-glass-plug, between burette and reservoir, with lateral stopcock, with solid ST-glass-plug, with 2 l reservoir bottle, without aspirator bulb, made of DURAN

Burettes automatiques de Pellet, classe AS *certifiée conforme, avec robinet entre la burette et le flacon à clé en verre creux interchangeable, robinet latéral à clé en verre interchangeable et flacon de 2 litres en verre clair borosilicaté, mais sans poire en caoutchouc*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.122.106**
25	0.05	± 0.03	**3.122.256**
50	0.10	± 0.05	**3.122.506**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.124.106**
25	0.05	± 0.03	**3.124.256**
50	0.10	± 0.05	**3.124.506**

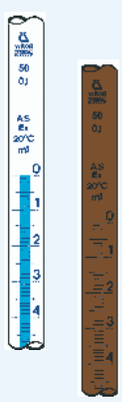

Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments, please refer to pages 171/1 and 171/2

Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG, veuillez svp vous référer aux pages 171/3 et 171/4

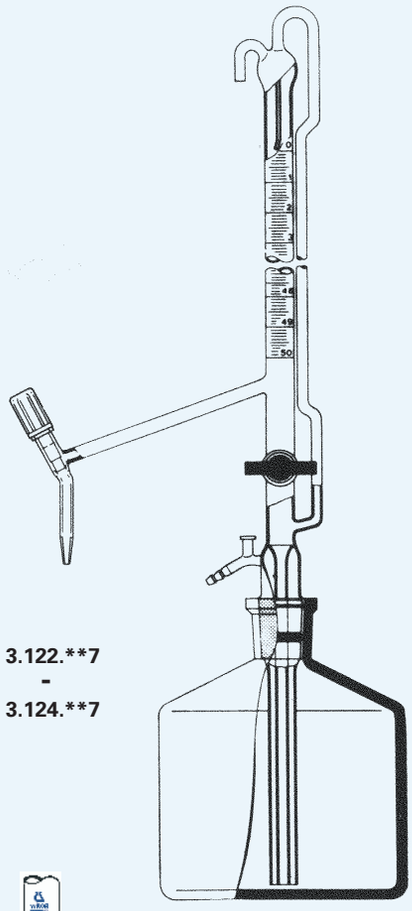

3.122.**7
-
3.124.**7

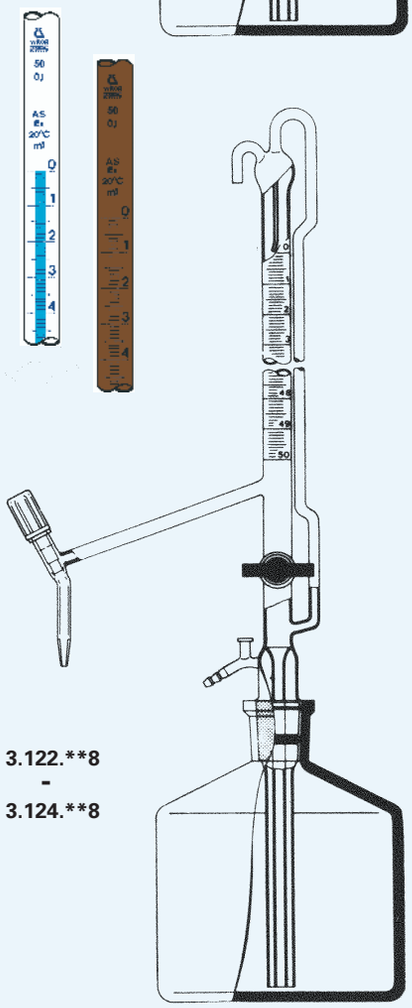

3.122.**8
-
3.124.**8

Automatic burettes, Pellet, class AS, conformity certified, main point ring-graduation, with stopcock, with hollow ST-glass-plug, between burette and reservoir, with lateral needle valve, with PTFE-needle valve, with overtwist device, with 2 l reservoir bottle, without aspirator bulb, made of DURAN

Burettes automatiques de Pellet, classe AS *certifiée conforme, avec robinet à clé en verre creux interchangeable entre la burette et le flacon, robinet latéral à vanne à iguille en téflon interchangeable et flacon de 2 litres en verre clair borosilicaté, mais sans poire en caoutchouc*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.122.107**
25	0.05	± 0.03	**3.122.257**
50	0.10	± 0.05	**3.122.507**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.124.107**
25	0.05	± 0.03	**3.124.257**
50	0.10	± 0.05	**3.124.507**

For the TITREX digital burettes, please refer to page 246
Pour les burettes digitales TITREX, se référer svp à la page 246

Automatic burettes, Pellet, class AS, conformity certified, main point ring-graduation, with stopcock, with ST-PTFE-plug, between burette and reservoir, with lateral needle valve, with PTFE-needle valve, with overtwist device, with 2 l reservoir bottle, without aspirator bulb, made of DURAN

Burettes automatiques de Pellet, classe AS *certifiée conforme, avec robinet entre la burette et le flacon à clé en téflon interchangeable, robinet latéral à vanne à aiguille en téflon interchangeable et flacon de 2 litres en verre clair borosilicaté, mais sans poire en caoutchouc*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.122.108**
25	0.05	± 0.03	**3.122.258**
50	0.10	± 0.05	**3.122.508**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.124.108**
25	0.05	± 0.03	**3.124.258**
50	0.10	± 0.05	**3.124.508**

Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments, please refer to pages 171/1 and 171/2
Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG, veuillez svp vous référer aux pages 171/3 et 171/4

Universal automatic burettes (DBGM), class AS, conformity certified, main point ring-graduation
With this universal automatic burettes you can work with pressure or vacuum and fill in these ways the fluids into the measuring tube. The titration under vacuum has the advantage that no bubbles exist. We deliver as a separate part an aspirator bulb wich is usable for vacuum and for pressure. The construction of this automatic burette shows considerable mechanical strength against the conventional burettes. with amber stain graduations and inscriptions DIFFICO, resistant to alkalis and acids and abrasion. With 2 l reservoir bottle ST 29/32. All plugs with screw-thread retaining nuts.
Delivery time 35 - 45 s, waiting time 30 s.
Made of borosilicate glass

Burettes graduées automatiques universelles, Classe AS certifiée conforme. Graduations et inscriptions en couleur marron.
En verre borosilicaté, avec ces burettes vous pouvez travailler sous pression ou sous vide et effectuer le remplissage dans le tube de mesure. En titrage sous vide il n'existe pas de bulles. Temps d'écoulement: 35-45 sec. et temps d'attente: 30 sec. Elles sont livrées avec un flacon de 2 litres à rodage normalisé 29/32, mais sans poire en caoutchouc

Universal automatic burettes, class AS, conformity certified, main point ring-graduation, with lateral stopcock, with solid ST-glass plug, made of DURAN

Burettes universelles automatiques Classe AS *certifiée conforme, en verre borosilicaté, avec robinet latéral à clé en verre plein interchangeable*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.152.104**
25	0.05	± 0.03	**3.152.254**
50	0.10	± 0.05	**3.152.504**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.154.104**
25	0.05	± 0.03	**3.154.254**
50	0.10	± 0.05	**3.154.504**

Universal automatic burettes, class DIN-AS, conformity certified, main point ring-graduation, with lateral needle valve stopcock, with PTFE-needle valve, made of DURAN

Burettes universelles automatiques Classe AS *certifiée conforme, en verre borosilicaté, avec robinet latéral à vanne à aiguille en Télon (PTFE) interchangeable*

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.152.105**
25	0.05	± 0.03	**3.152.255**
50	0.10	± 0.05	**3.152.505**

Amber glass

En verre brun borosilicaté

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
10	0.02	± 0.02	**3.154.105**
25	0.05	± 0.03	**3.154.255**
50	0.10	± 0.05	**3.154.505**

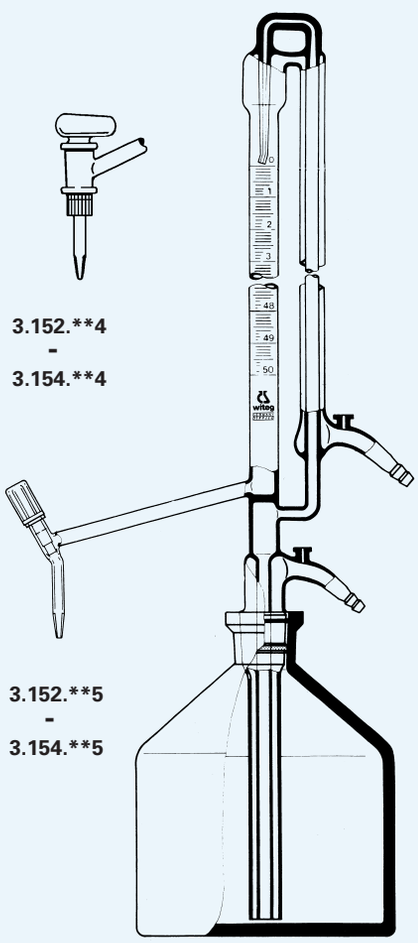

3.152.*4**
-
3.154.*4**

3.152.*5**
-
3.154.*5**

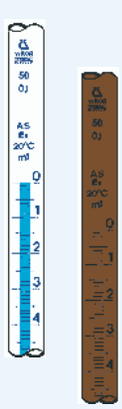

Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments, please refer to pages 171/1 and 171/2
Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG, veuillez svp vous référer aux pages 171/3 et 171/4





3.155.100
-
3.156.200



3.157.000

3.158.000

Accessories for automatic burettes

Accessoires pour les burettes automatiques

	Order No. *N° de code*
Reservoir bottle 1 l, ST 29/32, clear glass *Flacon de 1 litre en verre clair RN 29/32*	**3.155.100**
Reservoir bottle 2 l, ST 29/32, clear glass *Flacon de 2 litres en verre clair RN 29/32*	**3.155.200**
Reservoir bottle 1 l, ST 29/32, amber glass *Flacon de 1 litre en verre brun RN 29/32*	**3.156.100**
Reservoir bottle 2 l, ST 29/32, amber glass *Flacon de 2 litre en verre brun RN 29/32*	**3.156.200**
Aspirator bulb for pressure *Poire en caouthouc pour pression*	**3.157.000**
Aspirator bulb for vacuum *Poire en caouthouc pour pression*	**3.158.000**
Double suction bulb with net, made of PVC, black natural rubber, Size 5	**3.159.100**

Burettes, Daffert Pattern, class B, short line graduation with automatic zero point - with blue chemical resistant graduations and inscriptions. All plugs are screw thread retaining nuts. Better than class B accuracy. **Delivery time 30 - 100 s, without waiting time Made of DURAN**

Burettes droites à zéro automatique en haut, Classe B *en verre borosilicaté, graduations et inscriptions en couleur bleu.* ***Temps d'écoulement: 30-100 sec., sans temps d'attente***

Burettes, Daffert, class B, short line graduation, with two-way stopcock, with solid ST-glass plug

Burettes droites graduées à zéro automatique en haut, Classe B, *en verre clair borosilicaté, avec robinet à 2 voies à clé interchangeable*

Clear glass

En verre plein

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
25	0.05	± 0.04	**3.300.256**
50	0.10	± 0.08	**3.300.506**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
25	0.05	± 0.04	**3.302.256**
50	0.10	± 0.08	**3.302.506**

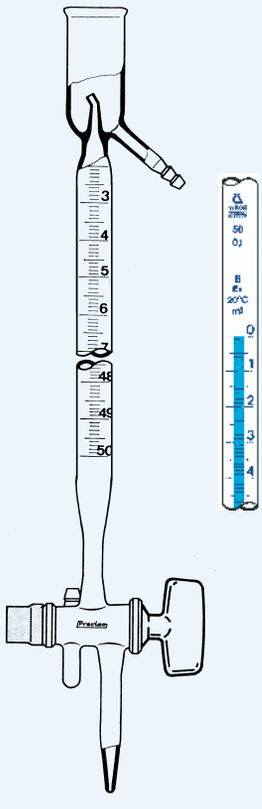

3.300.**6

Burettes, Daffert, class B, short line graduation, with two-way stopcock, with ST-PTFEplug

Burettes droites graduées à zéro automatique en haut, Classe B, *en verre clair borosilicaté, avec robinet à 2 voies à clé en Téflon (PTFE) interchangeable*

Clear glass

En verre plein

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
25	0.05	± 0.04	**3.300.257**
50	0.10	± 0.08	**3.300.507**

Schellbach blue line

Avec bande en émail bleu (Schellbach)

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
25	0.05	± 0.04	**3.302.257**
50	0.10	± 0.08	**3.302.507**

Automatic burettes, acc to Dr. Schilling, class B, short line graduation, with Schellbach blue line, new model, with push button enabling a prcise titration, complete with Polyethylene reservoir, included a stable base. Automatic zero point Pellet type. Amber stain DIFFICO-graduations and inscriptions. soda lime-glass. The burette is filled by thumb or finger pressure. Better than class B accuracy. **Delivery time 20 - 100 s, without waiting time**
Made of Borosilicate glass

Burettes automatiques de Schilling, classe B, *à bande en émail bleu de Schellbach, nouvelle version avec bouton à poussoir, complètes avec flacon en polyéthylène sur socle et burette en verre clair de chimie à graduations en couleur marron.* ***Temps d'écoulement: 30-60 sec. sans temps d'attente***

Capacity ***Capacité*** **ml**	**Division** ***Division*** **ml**	**Tolerance** ***Tolérance*** **ml**	**Order No.** ***N° de code***
5	0.02	± 0.02	**3.312.005**
10	0.05	± 0.05	**3.312.010**
15	0.10	± 0.04	**3.312.015**
25	0.10	± 0.10	**3.312.025**
50	0.10	± 0.10	**3.312.050**

Spare parts / *Pièces de rechange*

Burettes, 5 ml : 0.05 ml *Burettes, 5 ml : 0.05 ml*	**3.313.005**
Burettes, 10 ml : 0.02 ml *Burettes, 10 ml : 0.02 ml*	**3.313.010**
Burettes, 15 ml : 0.10 ml *Burettes, 15 ml : 0.10 ml*	**3.313.015**
Burettes, 25 ml : 0.10 ml *Burettes, 25 ml : 0.10 ml*	**3.313.025**
Burettes, 50 ml : 0.10 ml *Burettes, 50 ml : 0.10 ml*	**3.313.050**
Reservoir bottle, Polyethylene, 500 ml, for burettes 5 - 15 ml *Flacon en polyéthylène de 500 ml pour burettes de 5 à 15 ml*	**3.314.015**
Reservoir bottle, Polyethylene, 1000 ml, for burettes 25 - 50 ml *Flacon en polyéthylène de 100 ml pour burettes de 25 à 50 ml*	**3.314.050**
Plastic armature, for burettes 5 - 15 ml *Armature en plastique pour burettes de 5 à 15 ml*	**3.315.015**
Plastic armature, for burettes 25 - 50 ml *Armature en plastique pour burettes de 25-50 ml*	**3.315.050**
Plastic base, for reservoir bottle 500 ml *Socle en plastique pour flacon de 500 ml*	**3.316.015**
Plastic base, for reservoir bottle 1000 ml *Socle en plastique pour flacon de 1000 ml*	**3.316.050**

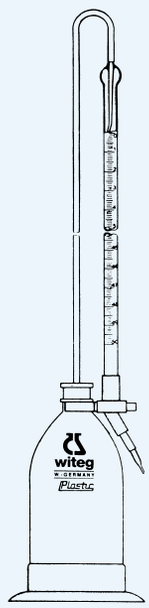

3.312.***

Micro burettes, acc. to DIN 12700, with amber stain DIFFICO-graduation, **with Schellbach blue line,** all plugs with screw thread retaining nuts, m**ade of DURAN,** delivery time 10 - 95 s, without waiting time

Microburettes selon DIN 12700 *à bande en émail bleu de Schellbach et graduations en couleur marron, en verre clair borosilicaté. Temps d'écoulement 10 - 95 sec., sans temps d'attente*

Micro burettes, Bang, class B, short line graduation, with stopcocks, with ST-glass plugs

Microburettes de Bang, classe B, *avec robinets à clés en verre interchangeables*

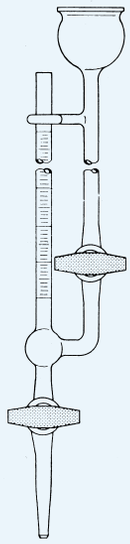

3.352.*3**

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
1	0.01	± 0.02	**3.352.012**
2	0.01	± 0.02	**3.352.022**
5	0.02	± 0.02	**3.352.052**
10	0.02	± 0.03	**3.352.102**

Micro burettes, Bang, class B, short line graduation, with stopcocks, with ST-PTFE-plugs

Microburettes droites de Bang, classe B, *avec robinets à clés en Téflon (PTFE) interchangeables*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
2	0.01	± 0.02	**3.352.023**
5	0.02	± 0.02	**3.352.053**
10	0.02	± 0.03	**3.352.103**

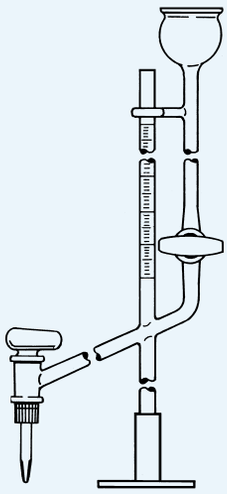

3.363.*2**

Micro burettes, Bang, class B, short line graduation, with lateral stopcock, with ST-glass plugs

Microburettes de Bang, classe B, *avec robinet latéral à clés en verre interchangeables et socle*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
1	0.01	± 0.02	**3.363.012**
2	0.01	± 0.02	**3.363.022**
5	0.02	± 0.02	**3.363.052**
10	0.02	± 0.03	**3.363.102**

Micro burettes, Bang, class B, short line graduation, with lateral stopcock, with ST-PTFE-plugs

Microburettes de Bang, classe B, *avec robinet latéral à clés en Téflon (PTFE) interchangeables et socle*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
2	0.01	± 0.02	**3.363.023**
5	0.02	± 0.02	**3.363.053**
10	0.02	± 0.03	**3.363.103**

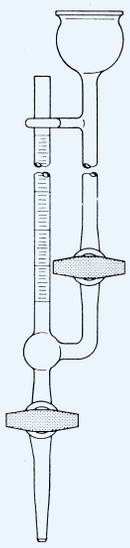

3.372.*3**

Micro burettes, Bang, class AS, for officially testing, main point ring-graduation, with stopcocks, with ST-glass plugs

Microburettes droite de Bang, classe AS *certifiée conforme, avec robinets à clé en verre interchangeables*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
1	0.01	± 0.006	**3.372.012**
2	0.01	± 0.01	**3.372.022**
5	0.02	± 0.01	**3.372.052**
10	0.02	± 0.02	**3.372.102**

Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments, please refer to pages 171/1 and 171/2
Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG, veuillez svp vous référer aux pages 171/3 et 171/4

Micro burettes, Bang, class AS, for officially testing, main point ring-graduation, with lateral needle valve stopcocks, with PTFE-needle valve

Microburettes de Bang, classe AS *certifiée conforme, avec robinet latéral à vanne à aiguille en Téflon (PTFE) interchangeables*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
2	0.01	± 0.01	**3.372.023**
5	0.02	± 0.01	**3.372.053**
10	0.02	± 0.02	**3.372.103**

Micro burettes, Bang, class class AS, short line graduation, with stopcocks, with ST-glass plugs

Microburettes droite de Bang, classe AS, *avec robinets à clé en verre interchangeables*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
1	0.01	± 0.006	**3.383.012**
2	0.01	± 0.01	**3.383.022**
5	0.02	± 0.01	**3.383.052**
10	0.02	± 0.02	**3.383.102**

Micro burettes, Bang, class class AS, short line graduation, with lateral stopcock, with ST-PTFE-plugs

Microburettes de Bang, classe AS, *avec robinet latéral à clé en en Téflon (PTFE) interchangeables et socle*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
1	0.01	± 0.006	**3.383.013**
2	0.01	± 0.01	**3.383.023**
5	0.02	± 0.01	**3.383.053**
10	0.02	± 0.02	**3.383.103**

Micro burettes, Bang, class class AS, short line graduation, with lateral stopcock, with PTFE needle valve

Microburettes de Bang, classe AS, *avec robinet latéral à clé à vanne à aiguille en Téflon (PTFE) et socle*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Order No. *N° de code*
2	0.01	± 0.01	**3.383.025**
5	0.02	± 0.01	**3.383.055**
10	0.02	± 0.02	**3.383.105**

Certificates for WITEG Diffico volumetric instruments, please refer to pages 171/1 and 171/2
Pour les Certificats des instruments volumétriques Diffico de WITEG, veuillez svp vous référer aux pages 171/3 et 171/4

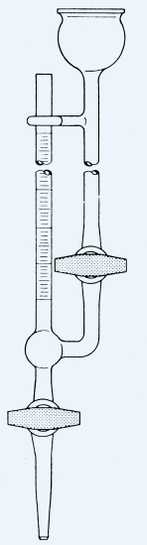

3.372.*3**

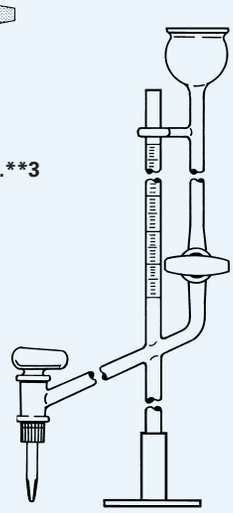

3.383.*2**

Pipettes
Pipettes

Graduated pipettes „Shortie“, class AS, main point ring-graduation with amber stain DIFFICO graduations and inscriptions, with tempered tips offering a wear resistance, which is up to seven times better than that of conventional pipette delivery tips Overall length 170 mm, „blow-out“, zero at the tip.
With mouth-piece for cotton plugging

Pipettes graduées courtes, classe AS certifiée conforme *avec graduations et inscriptions en couleur marron à zéro en bas, avec embout pour cotonnage, longueur totale 170 mm*

Capacity *Capacité* ml	Division *Division* ml	Tolerance *Tolérance* ml	Colour-code *Code-couleur*	Order No. *N° de code*
0.1	0.01	± 0.005		**3.405.001**
0.2	0.01	± 0.008		**3.405.002**
1	0.02	± 0.020		**3.405.102**
1	0.10	± 0.020		**3.405.110**
2	0.10	± 0.030		**3.405.210**
5	0.10	± 0.080		**3.405.510**
10	0.20	± 0.120		**3.405.710**

3.405.*****